

R7

OMRON

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
автоматический (на запястье)**



A Good Sense of Health

МОДЕЛЬ

OMRON R7 (HEM-637-E7)

ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ
РЕКОМЕНДУЕТ РЕГУЛЯРНО
ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

OMRON**R7****Введение****Уважаемые покупатели!**

Благодарим Вас за покупку продукции компании OMRON, известной своими передовыми технологиями. Приобретая измеритель артериального давления на запястье OMRON R7, снабжённый датчиком положения, Вы сделали выбор в пользу высококачественного и современного прибора. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны результатами измерения давления нашим прибором. Перед использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим Руководством. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно использования прибора, пожалуйста, обратитесь к представителю OMRON по адресу, указанному в конце руководства. Мы будем рады Вам помочь.

Тонومتر OMRON R7 оснащен разъемом для подключения к мини-принтеру OMRON и компьютеру. С помощью разъема Вы можете перенести данные из памяти тонометра в специальную программу. Программное обеспечение (ПО) позволяет просматривать, анализировать и распечатывать значения измерений артериального давления, выполненных с помощью тонометра OMRON R7. Программное обеспечение доступно только на английском языке. USB-кабель и мини-принтер компании OMRON приобретаются дополнительно. ПО Вы можете скачать на сайте официального дистрибьютора Компании OMRON – ЗАО "КомплектСервис" www.csmedica.ru

**Желаем Вам здоровья!**

OMRON

R7

Содержание

Перед проведением измерений артериального давления	4
Меры безопасности	6
Наименование и назначение частей прибора	8
Как установить элементы питания	9
Как установить дату и время	10
Как правильно измерять артериальное давление	11
Как принять правильную позу для измерений	12
Измерение артериального давления	13
Как пользоваться функцией “память”	15
Как пользоваться графической функцией	16
Как изменить установленные параметры	19
Авто-память	20
Датчик положения	20
Измерение давления на левом или правом запястье	21
Будильник	21
Время	22
Стирание данных	23
Сброс настроек	23
Использование дополнительного программного обеспечения	24
Использование дополнительного мини-принтера OMRON	25
Что такое артериальное давление	26
Артериальное давление на плече и на запястье	28
Уход и хранение	30
Индикация ошибок	31
Возможные неисправности и их устранение	32
Запасные части и комплектующие	33
Поверка	33
Технические характеристики	33
Адреса региональных торговых представительств и центров технического обслуживания OMRON HEALTHCARE в России	36




R7

Перед проведением измерений артериального давления







**Перед использованием прибора, пожалуйста,
внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности.**

- Показанные здесь предупреждающие знаки и символы приведены для безопасного и корректного использования прибора, а также для избежания риска причинения травмы себе и окружающим.
- Символы и их значения приведены ниже.

Предупреждающий знак	Содержание
<p>Предостережение</p> 	Указывает случаи, в которых риск телесных повреждений, или материального ущерба* может возрастать, как результат неправильного обращения.

* Материальный ущерб относится к достаточно широкому ряду повреждений, включая дом, предметы быта, домашних животных и пр.

ПРИМЕРЫ ЗНАЧКОВ

	Значок  обозначает запрещения (то, что нельзя делать). Действия, которые запрещены, указаны соответствующим текстом или рисунком в или рядом со значком  . Значок слева относится к "запрещению разборки".
	Значок  обозначает что-то обязательное (чему надлежит следовать всегда). Обязательные действия указаны соответствующим текстом или рисунком в или рядом со значком  . Значок слева относится к разряду "общеобязательных" обозначений.

OMRON

R7

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Постановка диагноза самостоятельно на основе полученных измерений и самолечение опасны. Пожалуйста, следуйте предписаниям врача.

- Самолечение может усугубить ход болезни.
- Развитие атеросклероза вследствие диабета, гиперлипемии или гипертонии может послужить причиной нарушения периферийных отделов кровообращения. В этих случаях измерения, проводимые на запястье и на плечевой артерии, могут значительно отличаться.



Не используйте прибор на младенцах, или лицах, не способных адекватно выразить свои намерения.

- Это может послужить причиной для их беспокойства и привести к нежелательным последствиям.

Не используйте прибор для иных целей, а только для измерения артериального давления.

- Это может привести к несчастному случаю.
- Это может послужить причиной для Вашего беспокойства и привести к нежелательным последствиям.

Не пользуйтесь мобильными и портативными телефонами вблизи работающего прибора.

- Это может стать причиной неправильной работы прибора.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать основной прибор или манжету.

- Получение корректных измерений может оказаться невозможным.



OMRON

R7

Меры безопасности

Важная информация, необходимая для получения достоверных показаний прибора

- Перед измерением давления воздержитесь от приёма пищи, алкоголя, курения, занятий спортом или приёма лекарств, так как всё это влияет на величину Вашего артериального давления.
- Перед началом измерения сядьте удобно на стул и расслабьтесь. Рекомендуется контролировать артериальное давление по меньшей мере дважды в день, утром, после того, как Вы встали, и вечером, или следовать рекомендациям лечащего врача.
- Не двигайтесь и не разговаривайте во время проведения измерений. Избегайте проведения измерений в движущемся транспорте.
- Обязательно делайте перерыв хотя бы в 3 минуты между двумя измерениями, чтобы восстановить циркуляцию крови и получить достоверные результаты. Всегда снимайте манжету в перерывах между измерениями.
- Освободите запястье, снимите часы и ювелирные украшения, прежде чем наложить манжету. Следите за тем, чтобы завёрнутый рукав Вашей одежды не нарушал циркуляцию крови.

Предостережения

- Прибор не подходит людям, страдающим атеросклерозом (потерей эластичности стенок артерий).
- Прибор не предназначен для мониторингования ЧСС у людей, пользующихся электрокардиостимулятором.
- Если Вы страдаете нарушением сердечного ритма, известным как аритмия сердца, Вам надлежит обязательно проконсультироваться у лечащего врача перед тем, как пользоваться прибором. В определённых случаях осциллометрический метод измерений может давать некорректные показания.

OMRON

R7

- В случае использования данного прибора во время беременности необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку это может влиять на получаемые результаты.

Пожалуйста, всегда помните: самостоятельный анализ результатов измерений не сможет заменить квалифицированный медицинский контроль. Вам ни в коем случае не следует изменять дозу принимаемого лекарственного препарата, предписанного врачом.

Перед тем, как использовать прибор OMRON R7 в первый раз.

OMRON R7 представляет собой компактный полностью автоматический измеритель артериального давления на запястье. Работая по осциллометрическому принципу, он измеряет Ваше артериальное давление и частоту пульса быстро и удобно, снимая показания непосредственно с запястья. Прибор обладает высоко технологичной системой контроля при проведении "фаззи-управляемого" (по технологии аппаратных средств "нечёткой логики") нагнетания воздуха, известного, как "интеллисенс". Это передовой метод проведения осциллометрических измерений, который не нуждается в предварительных установках и повторном нагнетании воздуха в манжету.

Прибор OMRON R7 обладает позиционным датчиком. Позиционный датчик способен определить оптимальную высоту расположения Вашего запястья (на уровне сердца) при проведении измерений артериального давления. Проведение измерений на уровне сердца крайне важно, поскольку снятие показаний при более высоком или более низком положении руки может дать неверные результаты.

Прибор OMRON R7 обладает большим цифровым матричным дисплеем, позволяющим увеличивать размер цифр и считывать показания графиков. Вместе со встроенной функцией "будильника", предназначенной для проведения измерений или приёма лекарств в одно и то же время, OMRON R7 является оптимальным прибором для контроля уровня Вашего артериального давления.

OMRON

R7

Электронный блок




Элементы питания



Руководство по эксплуатации



Футляр для хранения



Наименование и назначение частей прибора

Электронный блок

Разъем для подключения
к мини-принтеру OMRON
и компьютеру

Крышка
батарейного отсека

Манжета
для запястья





R7

Использование новых элементов питания (алкалиновых с продолжительным сроком службы) при нормальных условиях позволяет провести до 300 измерений. Пожалуйста, выключите прибор по окончании работы. Если Вы забудете это сделать, прибор отключится автоматически спустя 2 минуты. Пожалуйста, извлеките элементы питания из прибора, если Вы не собираетесь пользоваться им продолжительное время (более 2 месяцев).


Как установить дату и время

Перед использованием прибора OMRON R7 в первый раз надлежит установить дату и время. После включения прибора, нажав кнопку **O/I**, Вы увидите исходное состояние монитора в течение нескольких секунд (см. рис.) После этого произойдёт автоматическое переключение экрана в режим установки времени (TIME SET). (Для установки даты и времени см. также стр.19 главы "Как изменить установленные параметры").

После этого на экране отобразится Григорианский календарь(год/день/месяц). Значение года будет мигать.

1. Пользуясь кнопками **◀▶**, Вы можете Установить текущий год.
2. Нажимая кнопку **SET**, Вы можете зафиксировать значение года и перейти к следующему пункту.

Для установки месяца, даты и времени повторите пункты 1 и 2. После установки значения минут произойдёт переключение в режим стирания данных. Пожалуйста, выключите прибор, нажав кнопку **O/I**. Теперь Ваш прибор OMRON R7 готов к работе.



ИСХОДНЫЙ ЭКРАН


ЭКРАН УСТАНОВКИ
ВРЕМЕНИ



R7

Как правильно измерять артериальное давление


Как наложить манжету

Для проведения правильного измерения артериального давления необходимо наложить манжету на запястье надлежащим образом. При несоблюдении этого условия правильные измерения невозможны. Пожалуйста, следуйте указаниям (для левого запястья):



- 1) убедитесь, что рука обнажена;
- 2) убедитесь, что одежда не препятствует нормальному кровообращению;
- 3) убедитесь, что из меню настроек (см. стр. 19) выбран соответствующий режим измерений для запястья (левого или правого).

По умолчанию выбрано левое запястье.

- 4) Наложите манжету на левое запястье, руку держите большим пальцем вверх. Оставьте около 10-15 мм между краем манжеты и основанием ладони, как показано на рисунке.



- 5) Потяните край манжеты вверх и плотно закрепите её с помощью липучки, как показано на рисунке.



OMRON

R7

Вы можете использовать прибор OMRON R7 также и на правой руке, выбрав режим измерений для правого запястья в "установках".



Люди с тонким запястьем (с окружностью менее чем 145 мм) могут чувствовать ослабление манжеты, вследствие её недостаточно плотного крепления на руке. Пожалуйста, не прижимайте манжету, поскольку это не может повлиять на результаты измерений.

Как принять правильную позу для измерений

Достижение правильной позы перед проведением измерений важно, поскольку неправильная поза может послужить причиной некорректных показаний. Для достижения правильной позы следуйте указаниям (см. рисунки):

- сядьте и выпрямите спину;
- расслабьтесь, не напрягайте плечи и руки;
- глубоко вздохните несколько раз и вернитесь к нормальному дыханию;
- не поддерживайте запястье другой рукой и избегайте напряжения в руке, сжимая её в кулак или сильно вытягивая.





Правильная поза



Правильное положение



Неправильная поза



Неправильное положение


OMRON

R7

Как измерить артериальное давление и частоту пульса

По достижении правильной позы Вы можете начать измерения. При проведении измерений впервые будут включены позиционный датчик и сигнал, по умолчанию будет выбран режим измерения на левом запястье.

Нажмите кнопку **O/I** для активации прибора, и на экране отобразится режим позиционного датчика.

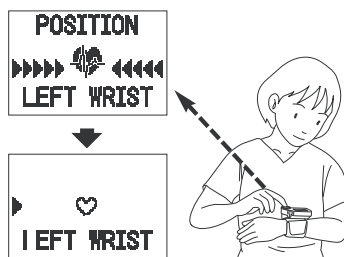

Измерение артериального давления

Поддерживайте Ваш локоть с помощью другой руки или используйте в качестве опоры стол во избежание лишних движений.

- Установите высоту положения запястья, используя локоть, как точку опоры.



Когда стрелка на дисплее прибора достигнет символа "сердце", Вы услышите звук зуммера, указывающий на то, что измеритель артериального давления находится на правильной высоте (на уровне сердца). После начала измерений изображение на дисплее будет меняться.

OMRON

R7



Как увеличить размер цифр на дисплее

Результаты измерения будут показаны на дисплее. Нажатием кнопки ◀ или ▶ можно увеличить размер цифр, отображаемых на дисплее.




OMRON

R7

Как пользоваться функцией "память"

Прибор OMRON R7 способен хранить в памяти максимум 90 измерений, включая дату и время. Если в памяти прибора уже хранится 90 измерений, то каждая новая запись будет стирать самую старую, освобождая ячейку памяти для сохранения значения нового измерения.




При выключенном приборе нажмите кнопку **M**. На дисплее отобразятся результаты последнего измерения. При каждом нажатии кнопки **◀** на дисплей будут выводиться результаты предыдущего измерения. Посредством нажатия кнопки **▶** на дисплей будут выводиться результаты последующего измерения.



Дата и время проведения измерений



При нажатии кнопки **GRAPH** выбранное измерение выводится на дисплей в виде еженедельного графика (см. раздел "Как пользоваться графической функцией"). Нажмите кнопку **M**, чтобы опять вернуться в режим отображения памяти на дисплее.



OMRON

R7

Как пользоваться графической функцией

Прибор способен отображать сохранённые результаты измерений в виде графика. Для получения наглядной картины состояния Вашего артериального давления измерения распределены по временным зонам:

- утро: измерения проведены между 0:00 и 9:59 утра,
- день: измерения проведены между 10:00 и 17:59,
- вечер: измерения проведены между 18:00 и 23:59.

В каждой временной зоне отображается только последнее измерение. Например, если вы проводите по 3 измерения в каждой временной зоне в один и тот же день, будет отображено только значение 3-го измерения. При этом все показания будут сохранены в памяти прибора. (См. также стр. 15).

Существуют 3 варианта графиков:

- график полных данных: отображает все измерения за неделю,
- график утренних данных: отображает все утренние измерения за неделю,
- график вечерних данных: отображает все вечерние измерения за неделю.

Не существует графика только для дневных измерений.

Для отображения графика нажмите кнопку **GRAPH** (ВЫЗОВ ГРАФИКА).

OMRON

R7

Снова нажмите кнопку **GRAPH** для отображения графика утренних данных.

Снова нажмите кнопку **GRAPH** для отображения графика вечерних данных.

При каждом нажатии кнопки **GRAPH** все эти режимы отображаются на дисплее в указанном порядке (полный, утренний, вечерний).




График полных данных



Отметка утренних данных

График утренних данных



Отметка вечерних данных

График вечерних данных


OMRON

R7


Объяснение графического изображения

При нажатии кнопки **GRAPH** показания последнего измерения высветятся на дисплее.

В приведённом примере измерение проведено 31 января в 22:40. График отображает значения 140 мм рт.ст. для систолического давления и 95 мм рт.ст. для диастолического (соответственно, верх и низ вертикальных полос) и частоту пульса, равную 90 ударам в минуту.

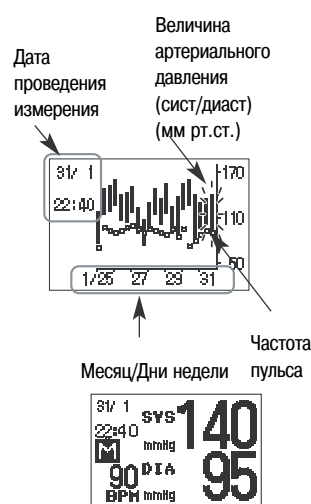

Детальная картинка данных на мигающем дисплее



Картинка на дисплее, где систолическое давление дважды превышает 170 мм рт.ст.

Картинка "гипертония"

Систолическое давление превышает 170 мм рт.ст.

Когда дважды систолическое давление превысит значение 170 мм рт.ст., на графике появится символ "стрелка вверх". Если систолическое давление трижды превысит значение 170 мм рт.ст., символ "стрелка вверх" исчезнет, и экран автоматически переключится в режим "гипертония".

Максимальная отображаемая величина артериального давления (ось Y в системе координат) изменится со 170 до 210 мм рт.ст.




R7

Как изменить установленные параметры

Настройки на приборе OMRON R7 могут быть изменены по Вашему желанию и для Вашего удобства. Для входа в меню "Настройки", пожалуйста, нажмите кнопку **SET** при выключенном приборе. Используя кнопки **◀▶**, можно выбрать предпочтительный режим настроек. Повторным нажатием кнопки **SET** можно зафиксировать выбранную настройку и перейти к следующему этапу, как показано на рисунке. Используйте кнопку **O/I** для того, чтобы снова выключить прибор.

- При нажатии кнопки **SET** при выключенном питании на дисплее отобразятся картинки настроек в последовательности, указанной на рисунке.
- Вы можете выбрать настройки или установить дату и время с помощью этих кнопок
- Для завершения настроек нажмите кнопку **O/I**






R7

Автопамять

Вы можете активировать либо деактивировать функцию "память" на приборе. При отключенной функции авто-памяти измерения не будут сохраняться. При использовании прибором OMRON R7 более чем одним человеком, рекомендуется отключить функцию памяти. При покупке прибора OMRON R7 функция памяти включена (по умолчанию).



Автоматическая память включена (ON) Автоматическая память выключена (OFF)

Датчик положения

Датчик положения прибора OMRON R7 может быть включён (ON), или выключен (OFF). В заводских настройках (по умолчанию) датчик положения включён. При включенном датчике положения Вы можете выбрать оптимальное положение запястья, которое будет сопровождаться звуковым сигналом.



Картинка
Датчика
Положения

Картинка
выключенного
Датчика положения

Картинка включенного
Позиционного Датчика
и выключенного сигнала

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на электронный блок

Срок гарантии 5 лет

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ "О защите прав потребителей", регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - использования прибора с нарушением требований Руководства по эксплуатации;
 - при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - наличия механических или иных повреждений изделия;
 - проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, а так же расходных материалов (элементов питания, манжет и т.д.);
 - использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

Срок службы: электронный блок – не менее 10 лет.

В зависимости от модели, в состав измерителя артериального давления могут входить следующие комплектующие и (или) расходные материалы:

Комплектующие и (или) расходные материалы	Срок гарантии	Срок службы
манжета компрессионная	1 год	1 год
груша для нагнетания воздуха	1 год	1 год
кабель USB	1 год	1 год
адаптер сетевой	2 года	7 лет
элементы питания	устанавливает производитель этих элементов питания	

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 "...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации".

В соответствии с Законом "О защите прав потребителя" "...изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости **провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.**

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара".

**АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
OMRON HEALTHCARE В РОССИИ**

приведены в конце настоящего Руководства по эксплуатации

Дата продажи _____

Штамп магазина **Подпись продавца** _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заклучение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____


Подпись Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

Дата обращения _____

Заклучение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)



Уважаемые покупатели!



Наряду с измерителями артериального давления компания OMRON производит целый спектр медицинских приборов, помогающих сохранять здоровье и вести здоровый образ жизни как Вам, так и Вашей семье. Среди них:

- **ингаляторы OMRON** для ингаляционного лечения.

Одним из эффективных способов лечения **бронхиальной астмы** и **аллергии** является ингаляторная терапия.

При использовании ингалятора лекарственный препарат попадает непосредственно к органам дыхания, минуя кровь. Неблагоприятные побочные явления лекарства сводятся к минимуму.

Ингаляторная терапия значительно облегчает течение болезни в периоды ее обострений;


- **определитель жировых отложений OMRON** позволяет узнать точное количество и процентное содержание жира в организме;
- **компактные шагомеры OMRON** покажут Вам, сколько было сделано шагов и истрачено калорий при беге или пеших прогулках в течении дня;
- **медицинские массажеры OMRON** применяются для миотерапии при:
 - мышечной боли;
 - мышечной усталости;
 - напряжении в мышцах;
- **электронные термометры OMRON** для измерения температуры у детей безопасны для ребенка, не содержат вредных веществ и не бьются.

Будьте здоровы вместе с OMRON!




Измерение давления на левом или правом запястье

Обычно артериальное давление измеряется на левом запястье (заводская настройка). Прибор OMRON R7 позволяет проводить измерения как на правом, так и на левом запястье. Для сравнения колебаний артериального давления рекомендуется снимать показания с одного и того же запястья.



Картинка измерений на левом запястье



Картинка измерений на правом запястье

Будильник

Ваш измеритель артериального давления на запястье позволяет установить функцию "будильник" на два напоминания в сутки. Функция "будильник" может быть использована для слежения за артериальным давлением в одно и то же время каждый день, или для напоминания о времени приёма лекарств.



Картинка будильника



Картинка звонящего будильника



R7

Будильник будет звонить в течение 2 минут. Будильник останавливается нажатием кнопки **O/I**. Сигнал будильника не включится во время использования прибора (например, для измерений или графического отображения) в установленное на будильнике время.

Вы можете установить требуемое время нажатием кнопки **◀▶** при мигании символа на дисплее. Нажмите кнопку **SET** для фиксации значения часа и перехода к настройке следующего параметра. Нажатием кнопки **◀▶** установите значение минут. Нажмите кнопку **SET** для подтверждения и продолжения. Нажмите какую-либо из "стрелок" для активации (**☀**), или деактивации (**☾**) будильника. Нажмите кнопку **SET** для фиксации выбранных настроек.

Время

Вы можете изменять настройки даты и времени на приборе OMRON R7.

В режиме установки времени на дисплее отобразится Грегорианский календарь. Значение года будет мигать.


1. Используя кнопку **◀▶** можно установить текущий год.
2. Нажатием кнопки **SET**, можно зафиксировать выбранное значение года и перейти к следующей настройке.

Для установки месяца, даты, и времени повторите шаги 1 и 2.

После установки значения минут экран переключится в режим удаления данных (DELETE DATA).



Картинка установки времени



Картинка полного стирания данных из памяти



R7

Стирание данных

В этом режиме Вы можете стереть все результаты, хранящиеся в памяти прибора. Пожалуйста, будьте осторожны, поскольку стёртые данные не могут быть восстановлены. В режиме заводской установки эта функция отключена (NO). Если Вы выбрали ДА (YES), прибор запросит подтверждение "ВЫ УБЕРЕНЫ?" (ARE YOU SURE?) Для отмены выберите NO, для подтверждения уничтожения данных выберите YES.



Картинка запроса на подтверждение

После стирания всех хранившихся результатов на дисплее появится надпись "DATA DELETED SCREEN". Все данные будут стёрты и прибор отключится.





Картинка стёртых данных

Если сохранённые измерения не стёрты (ответ NO), Вы переключитесь в режим "СБРОС НАСТРОЕК" (RESET SETTINGS).

Сброс настроек

В этом меню Вы можете выбрать режим возвращения всех настроек в исходные (заводские) установки. Заводской установкой для этого меню является NO. Если Вы выбрали ДА (YES), прибор запросит подтверждение "ВЫ УБЕРЕНЫ?" (ARE YOU SURE?). После получения подтверждения выбрав YES, все настройки будут приведены к первоначальным (заводским) значениям.



Прибор вернётся в режим "АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ" (AUTO MEMORY). Теперь Вы можете выключить прибор, нажав кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ".

OMRON

R7

Использование дополнительного программного обеспечения (ПО)

Перед установкой ПО на компьютер прочтите "Руководство по установке", которое Вы можете также скачать на сайте www.csmedica.ru. Используйте кабель для подключения к компьютеру, разрешенный компанией OMRON. Использование какого-либо другого кабеля может привести к повреждению устройства, а также повлечет прекращение гарантии.

1. Откройте крышку USB-порта для подключения к компьютеру/мини-принтеру. Крышка находится на верхней панели прибора над значком Vi.
2. Подсоедините USB-разъем шнура (меньший разъем) к порту на тонометре R7.
3. Подключите USB-разъем (большой разъем) к персональному компьютеру.

OMRON

R7

Использование дополнительного мини-принтера

Перед использованием мини-принтера OMRON прочтите "Руководство по эксплуатации" мини-принтера.

1. Извлеките разъем кабеля из мини-принтера.
2. Подсоедините разъем кабеля мини-принтера к тонометру.

Далее действуйте в соответствии с рекомендациями, изложенными в "Руководство по эксплуатации" мини-принтера OMRON.

OMRON

R7

Что такое артериальное давление

Кровь перекачивается по артериям посредством сокращений и расширений "насоса", называемого сердцем. Давление при выталкивании крови из сердца в артерии называется систолическим давлением. Давление при расслаблении сердечной мышцы и расширении сердца, когда кровь возвращается обратно после циркуляции по телу, называется диастолическим давлением.

Артериальное давление постоянно колеблется в течение дня, с возрастом изменяется состояние здоровья. Гипертония является плохим показателем, который может привести к опасным заболеваниям, таким как церебральная апоплексия, или инфаркт миокарда. Внимание к состоянию артериального давления поможет охарактеризовать состояние Вашего здоровья и образ жизни в целом.




OMRON

R7

Классификация артериального давления

Классификация артериального давления, показанная на рисунке, разработана Всемирной Организацией Здравоохранения и Международной Лигой Гипертонии. Используйте эту классификацию для определения состояния своего артериального давления. Однако если состояние артериального давления вызывает у Вас беспокойство, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не существует универсально принятого определения гипотонии. Вообще говоря, пациенты, имеющие величину систолического давления ниже 100 мм рт.ст., считаются склонными к гипотонии.

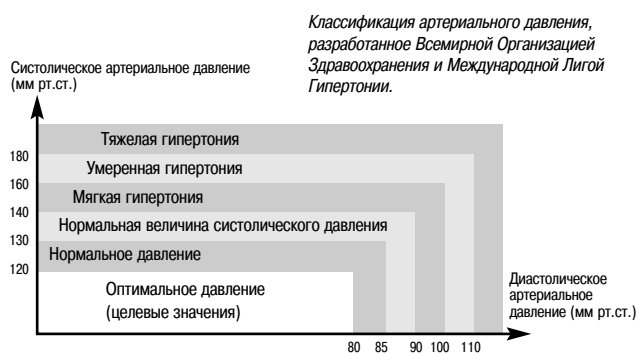

OMRON

R7

Артериальное давление на плече и на запястье

Измеритель артериального давления на запястье

Артериальное давление обычно измеряется на плечевой артерии. Так как запястная артерия соединена с плечевой артерией, величина артериального давления на запястье близка по значению к величине давления в плечевой артерии и отображает все изменения давления в плечевой артерии. Однако, из-за нарушения кровообращения за счет поражения артерий может наблюдаться достаточно большая разница между полученными значениями давления при измерении на плече и на запястье.

В таком случае для наблюдения состояния Вашего артериального давления пользуйтесь измерениями как на плече, так и на запястье и консультируйтесь с врачом.



Заболевания, влияющие на показатели артериального давления



Диабет, гиперлипемия, гипертония способствуют развитию артериального склероза, являющегося причиной опасных заболеваний, таких как церебральная апоплексия или инфаркт миокарда, вызывают сужение артерий, или нарушение периферийного кровообращения. В этих случаях показатели запястного и плечевого давления могут сильно отличаться. Даже у здоровых людей показания могут отличаться на 20 мм.рт.ст., при проведении измерений в неблагоприятных условиях. Поэтому не пытайтесь самостоятельно осуществлять диагностику на основании получен-

OMRON

R7

ных результатов, обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

В дополнение к этому, разница в показаниях между запястным и плечевым давлением может некоторым образом подвергаться влиянию физиологического состояния пациента во время измерений. Однако, величины артериального давления, полученные при измерении на запястье или плече, обычно колеблются одинаково. Поэтому можно увидеть тенденцию колебания артериального давления, измеряя давление на запястье.

Разница в показаниях артериального давления, измеренного в домашних условиях и в кабинете врача

Обычно артериальное давление, измеряемое в домашних условиях, бывает несколько ниже, чем давление, измеряемое в кабинете врача. Разница может достигать 20 мм рт.ст., поскольку в домашней обстановке пациент чувствует себя более расслабленно и, наоборот, более напряженно при посещении врача. Для успешного анализа Вашего артериального давления важно отслеживать и регистрировать его уровень в домашних условиях.



R7

Уход и хранение

- Для чистки прибора пользуйтесь только мягкой, слегка увлажнённой тканью.
- **Не используйте бензин, спирт, растворители и сходные жидкости!**
- Пятна на манжете могут быть аккуратно устранены с помощью увлажнённой ткани и мыльной воды.
- **Не мойте прибор и предохраняйте его от попадания влаги внутрь!**
- Держите прибор в футляре и месте, предохраняющем от экстремальных перепадов температуры и влажности.
- Не проводите какой-либо ремонт самостоятельно. При обнаружении неисправности немедленно обратитесь по месту приобретения прибора или к авторизованному дилеру компании OMRON.
- Пожалуйста, вынимайте элементы питания, если Вы не собираетесь пользоваться прибором долгое время (более 2 месяца).
- Электромагнитные поля могут влиять на результаты измерений. Не пользуйтесь портативными и мобильными телефонами вблизи работающего прибора.
- Рекомендуется один раз в 2 года проверять работоспособность и точность показаний прибора в сервисных центрах OMRON.

Надлежащая утилизация прибора (использованное электрическое и электронное оборудование)



Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.




Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.



R7

Индикация ошибок

При неправильном проведении измерений на дисплее могут отображаться следующие ошибки.

Ошибка	Причина	Способ устранения
 <p>Через несколько секунд</p>	Вы шевелили запястьем во время измерений	Повторите измерение; постарайтесь, чтобы Ваше запястье оставалось неподвижным до конца измерения. (см. стр.13)
 <p>Через несколько секунд</p>	Вы шевелили рукой или телом или разговаривали во время измерений	Повторите измерение, сохраняя неподвижность до конца измерения (см. стр.13)
 <p>Через несколько секунд</p>	Вы активно двигали рукой или телом во время измерения	Повторить измерение, сохраняя неподвижность до конца измерения (См. стр.13)
 <p>Мигает символ замены элементов питания</p>	Элементы питания разряжены	Следуя инструкции замените оба элемента питания на новые (см. стр.9)
 <p>Индцируется символ E и цифры.</p>	Неисправность электронного блока	Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр OMRON

Если Вам не удаётся разрешить возникшие трудности даже после выполнения перечисленных выше процедур, обратитесь в ближайший сервисный центр OMRON.

OMRON

R7

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Ничего не отображается на дисплее после нажатия кнопки "ВКЛ/ВыКЛ"	Элементы питания разряжены	Замените элементы питания новыми. (см. стр.9)
	Не соблюдена полярность при установке элементов питания (+ и -)	Установите элементы питания, соблюдая полярность
Измерение невозможно, или же величина артериального давления непомерно завышена (занижена).	Манжета на запястье расположена не на уровне сердца	Добейтесь правильного положения запястья и повторите измерения (см. стр. 12)
	Манжета неплотно прилегает к запястью	Правильно наложите манжету (см.стр. 11)
	Ваш плечевой пояс или рука слишком напряжены	Расслабьтесь и проведите измерение
	Вы разговаривали или двигали рукой во время измерения	Сохраняйте неподвижность и не разговаривайте во время измерения
Величина артериального давления отличается от величины, измеренной на плечевой артерии	См. раздел "Артериальное давление на плече и на запястье" (см. стр. 30)	
Показание артериального давления отображается на дисплее прежде, чем прибор создал требуемую величину компрессии.	Происходит утечка воздуха из манжеты.	Обратитесь по месту приобретения прибора, или к ближайшему поставщику продукции OMRON
Значения артериального давления изменяются при каждом измерении, или показания артериального давления неправдоподобно велики (малы)	Значения артериального давления имеют тенденцию к изменению в зависимости от Вашего эмоционального состояния или времени проведения измерений. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и повторите измерение	

Если Вам не удастся разрешить возникшие трудности даже после выполнения перечисленных выше процедур, обратитесь в ближайший сервисный центр OMRON.

OMRON**R7****Запасные части и комплектующие**

Благодаря высоким стандартам качества продукции, изделия OMRON не рассчитаны на замену частей, ввиду необходимости последующей специальной калибровки подвергнутых замене высокотехнологичных компонентов. Манжета может быть заменена только авторизованным специалистом.

Поверка

Прибор поверен первично по импорту, клеймо находится на последнем листе гарантийного талона или руководства по эксплуатации. Знак утверждения типа находится на титульном листе руководства по эксплуатации. Поверку проводят по документу МИ 2582-2000 «Рекомендация. ГСИ. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические и полуавтоматические OMRON и MARSHALL. Методика поверки», утвержденному ВНИИОФИ и зарегистрированному ВНИИМС. Межповерочный интервал 2 года.

Технические характеристики

Название прибора	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический
Модель	OMRON R7 (HEM-637-E7)
Дисплей	Матричный жидкокристаллический
Метод измерения	Осциллометрический
Диапазон измерений – давления воздуха в компрессионной манжете – частоты пульса	0-299 мм рт.ст. 40-180 ударов/мин.
Допускаемая погрешность прибора при измерении: – давления воздуха в компрессионной манжете – частоты пульса	± 3 мм рт.ст. ± 5%
Компрессия	Автоматическая, с помощью компрессора



R7

Декомпрессия	Автоматическая скоростная
Способ определения давления	При помощи электростатического ёмкостного полупроводникового датчика давления
Источник питания	Два щелочных элемента питания типа LR03 (AAA)
Срок годности элементов питания при использовании щелочных элементов питания	Около 300 измерений (при условии, что прибор используется при комнатной температуре около 22°C не более 3 раз в день и измеряемое давление составляет 170 мм рт.ст.)
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха – относительная влажность	от +10°C до +40°C от 30% до 85% отсутствие чрезмерных вибраций, сотрясений, воздействий сильных магнитных и электрических полей
Условия хранения: – температура окружающего воздуха – относительная влажность	от -20°C до +60°C от 10% до 95%
Длина окружности руки, на которую рассчитана манжета	от 135 до 215 мм
Масса электронного блока без элементов питания	не более 150 г
Габаритные размеры электронного блока	не более 78 x 66 x 38 мм
Защита от удара током	Применение внутреннего источника питания, тип В.
Комплект поставки	Электронный блок с манжетой, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, футляр для хранения прибора, комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, информационный лист
Срок службы, не менее: – электронного блока – манжеты – элементов питания	10 лет 2000 измерений или 2 года устанавливается производителем этих элементов

OMRON

R7

В интересах модернизации и улучшения прибора, технические характеристики могут быть изменены без предварительного объявления.



=Тип В



0197

Прибор произведен в полном соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС (Директива по медицинскому оборудованию) и разработан в соответствии с европейским стандартом EN 1060 "Неинвазивные сфигмоманометры", Часть 1 "общие требования" и Часть 3 "Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения артериального давления".

Автоматические измерители артериального давления и частоты пульса OMRON R7 (HEM-637-E7) испытаны и зарегистрированы в России:
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04721 от 18.09.2012 г.
Срок действия не ограничен.

- СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ

Декларация о соответствии № РОСС JP.ME20.Д01213 от 02.10.2012 г.
Срок действия до 02.10.2015 г. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 5267.0.2-2005, ГОСТ Р 51959.1-2002, ГОСТ Р 51959.3-2002.

Производитель:

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.)
53, Kinotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002, JAPAN
(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото, 617-0002, ЯПОНИЯ)

Представитель в Европе: OMRON

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp THE NETHERLANDS (Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп НИДЕРЛАНДЫ)

www.omron-healthcare.com

Производственное подразделение:

OMRON DALIAN Co., Ltd. (ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко., Лтд.)
Economic & Technical Development Zone №3 Song Jiang Road, Dalian 116600, China
(Экономик энд Техникал Девелопмент Зоне № 3 Сонг Янг Роуд, Далянь 116600, Китай)



R7

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON в России
 Юридический адрес: 123557, Москва, Б. Тишинский пер., д. 26, корп. 13-14
 Адрес и телефоны Центра технического обслуживания OMRON: 127006, Москва, Ворониковский пер., д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская») Тел/факс: (495) 221-73-45 (многоканальный)
 E-mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)
 www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического обслуживания OMRON:
 пн-пт: с 09.30 до 19.00 (без перерыва на обед),
 сб: с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед),
 вс и праздничные дни - выходной



- Альметьевск, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Кирова, д. 13А, тел.: (8553) 45-26-96, (951) 063-88-51, csmedica16-9@mail.ru
- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: 8 (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Ефремова, д. 101, тел.: (86137) 58-202, cs_mediam@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», пр. Дзержинского, д. 8, корп. 1, оф. 3, тел.: (8182) 67-25-26, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barناول@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Пирогова, д. 45, тел.: (4722) 75-36-10, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 7, оф. 321, тел.: (4162) 42-12-23, csmedica_amur@tsl.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2 Советский переулок, д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: 8 (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Н.Дуброва, д. 30А, тел.: (4922) 54-14-28, 37-01-67, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7,




- тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Грамши, д. 73 а, тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.vn.ru
- Екатеринбург, ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. Союзная, д. 49а, оф. 4, тел.: (3412) 36-76-60, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Восток», ул. Карла Либкнехта, д. 121, тел.: (3952) 205-141, 206-687, 298-458, 298-456, 291-268, vostok@csmedicairk.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mari-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, csmedica16-wln@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, 8 (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Тухачевского, д. 22а, оф. 132, тел.: (3842) 31-06-19, 59-22-02, nikitin_cs@mail.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (861) 210-01-92, 210-01-35, cs_medica@kubannet.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. Заводская, д. 5а, оф. 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. Угловая, д. 15, тел.: (4742) 27-03-78, 28-14-70, cslip2009@yandex.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Урал» (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 143/3, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica-ural.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Аскерханова, д. 5В, оф. 1, тел.: (8722) 63-32-06, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные воды, ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс 6-06-48, csmedicasakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск),

OMRON

R7

- просп. Ленина, д. 5, оф. 1, тел.: (8152) 25-53-43, murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
 - Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Таёжная, д. 27, оф. 2, тел.: 8-902-855-85-01, cstyumen@mail.ru
 - Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
 - Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», просп. Курако, д. 16, оф. 82, тел.: (3843) 74-03-43, povokuznetsk@csmedica.ru, mikheev@csmedica.ru
 - Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Энгельса, д. 78, тел.: (8617) 72-35-40, cs_medipanov@mail.ru
 - Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
 - Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Косарева, д. 103, тел.: (3812) 21-03-00, 25-54-66, 59-55-03, csmedika_omsk@mail.ru
 - Орёл, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 8 Марта, д. 8, оф. 70, тел.: (4862) 43-67-99, orel-cs@mail.ru
 - Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
 - Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, cspodmoskovie@mail.ru
 - Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
 - Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, permt@csmedica.ru
 - Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Мерещкого, д. 16, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
 - Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: 8 (911) 885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru
 - Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
 - Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
 - Самара, ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 300, тел.: (846) 267-38-33, 273-83-63, 273-83-22, csmedica-samara@sata.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, литер 1, оф. 24, тел.: (846) 267-38-40
 - Санкт-Петербург, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», 6-я Красноармейская ул., д. 5/7, тел. (812) 309-09-80, csnw@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр, Малодетское сельский просп., д. 36, тел. (812) 715-88-93, spservice@csmedica.ru
 - Саранск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), ул. Пролетарская, д. 130, оф. 10, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
 - Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Шелковичная, д. 64/66, оф. 6, тел.: (8452) 57-84-60, 57-84-61, csmsaratov@mail.ru

OMRON**R7**

- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (83130) 6-39-59, medica_sar@mail.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 28, тел.: (8622) 64-74-67, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. 30 лет Победы, д. 44/3, здание офис-центра «Мидгорд», оф. «Омрон», тел.: 8-912-817-41-41, cssurgui@mail.ru
- Сызрань, ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Московская, д. 4, тел.: (8464) 92-25-49, sismedica@mail.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Чичканова, д. 48, №16, тел.: (4752) 53-51-94, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», Ленинский просп., д. 8а, оф. 3, тел.: (8482) 74-88-89, csmedica-tft@yandex.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Енисей» (Красноярск), ул. Нахимова, 13/1, оф. 304, тел.: (3822) 25-23-44, 41-23-51, tomsk@csmedicaenisey.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 19, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 2, оф. 2., тел.: 8-908-873-30-47, (3452) 30-46-17, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica@mv.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 103, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csmedica@chubarshia.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica-ural.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда», ул. Краснодонцев, д. 24, оф. 1, тел.: (8202) 20-55-33, csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110 а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Свердлова, д. 40, тел.: (4852) 90-66-53, 73-95-04, 73-99-40, 71-40-08, yaroslavl@csmedica.ru

Сведения о поверке:

Модель **OMRON R7 (HEM-637-E7)** _____

Прибор заводской № _____

• Прошел первичную поверку
Дата поверки _____

• Прошел периодическую поверку
Дата поверки _____



СиЭс МЕДИКА

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON в России

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

**По вопросам сервисного обслуживания и консультаций
обращайтесь по адресу:**
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (495) 221-73-45 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru сиэсмедика.рф